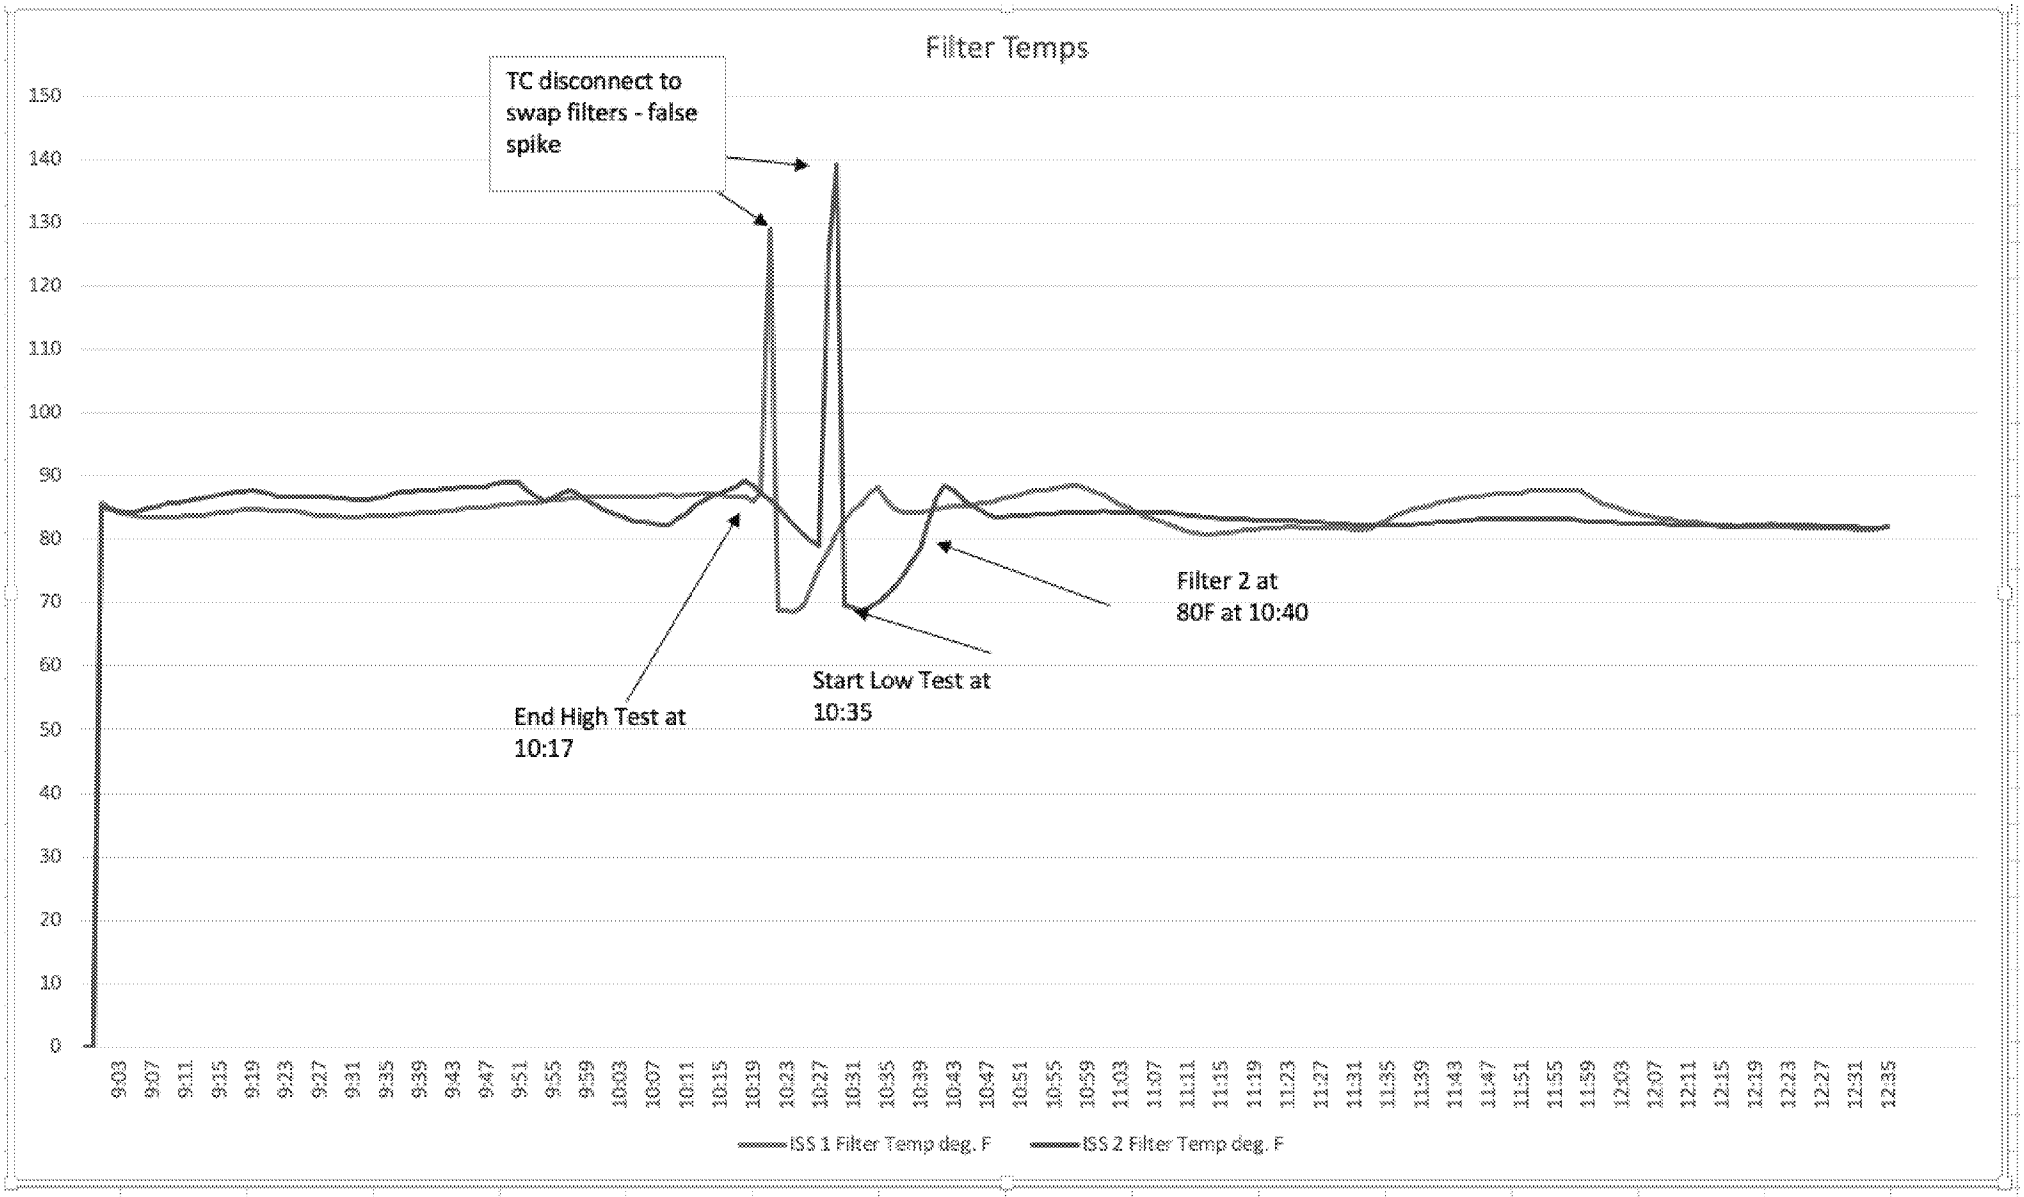
Filter Temps
TC disconnect to swap filters - false spike
Filter 2 at 80F at 10:40
Start Low Test at 10:35
End High Test at 10:17
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
9:03
9:07
9:11
9:15
9:19
9:23
9:27
9:31
9:35
9:39
9:43
9:47
9:51
9:55
9:59
10:03
10:07
10:11
10:15
10:19
10:23
10:27
10:31
10:35
10:39
10:43
10:47
10:51
10:55
10:59
11:03
11:07
11:11
11:15
11:19
11:23
11:27
11:31
11:35
11:39
11:43
11:47
11:51
11:55
11:59
12:03
12:07
12:11
12:15
12:19
12:23
12:27
12:31
12:35
ISS 1 Filter Temp deg. F
ISS 2 Filter Temp deg. F